




SISTEMAS DE IMPLANTES  
IMPLANT SYSTEMS

[www.gmidental.com](http://www.gmidental.com)

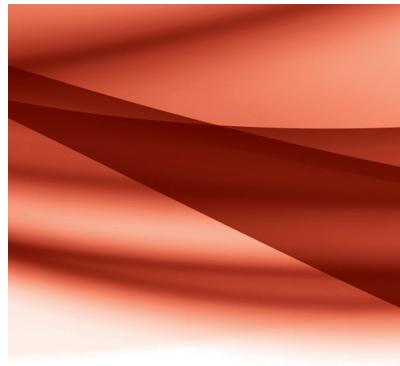

Implantes dentales de conexión interna hexagonal  
Hexagonal internal connection dental implants

Made in Spain





## Índice - Summary

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tratamiento superficial / estudios
- Recomendaciones de uso
- Descripción del etiquetado

### SISTEMAS DE IMPLANTES

- Implantes dentales **gmi frontier**
- Protocolo de inserción de implantes **gmi frontier**
- Gama de implantes **gmi frontier**
- Secuencias fresado para implantes **gmi frontier**
- Implantes dentales **gmi frontier PEAK**
- Protocolo de inserción de implantes **gmi frontier PEAK**
- Gama de implantes **gmi frontier PEAK**
- Secuencias fresado para implantes **gmi frontier PEAK**

### ADITAMENTOS

- Pilares cicatrización **gmi frontier**
- Pilares fresables **gmi frontier**
- Pilares inclinados estéticos **gmi frontier**
- Pilares rectos **gmi frontier**
- Pilares provisionales **gmi frontier**
- Base titanio **gmi frontier**
- Pilares bola **gmi frontier**
- Pilares multi-estético **gmi frontier**
- Bases bioestéticas **gmi frontier**
- Réplicas **gmi frontier**
- Tomas de impresión **gmi frontier**
- Calcinables **gmi frontier**
- Bases CrCo **gmi frontier**
- Tornillos clínica y laboratorio **gmi frontier**
- Tornillos PME y BE **gmi frontier**
- Pares recomendados de apriete

### KITS QUIRÚRGICOS GMI

- Kit quirúrgico **gmi frontier/avantgard**
- Kit quirúrgico **gmi PEAK**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### KEY FEATURES

- Surface treatment / studies 4
- Recommendations of use 6
- Labelling description 7

### IMPLANT SYSTEMS

- **gmi frontier dental implants** 8
- Insertion sequence for **gmi frontier** implants 9
- **gmi frontier implants range** 10
- Drilling sequences for **gmi frontier** implants 12
- **gmi frontier PEAK dental implants** 14
- Insertion sequence for **gmi frontier PEAK** implants 15
- **gmi frontier PEAK implants range** 16
- Drilling sequences for **gmi frontier PEAK** implants 17

### ATTACHMENTS

- **gmi frontier healing abutments** 18
- **gmi frontier millable-implant abutments** 19
- **gmi frontier esthetic angled abutments** 20
- **gmi frontier straight abutments** 20
- **gmi frontier temporary cylinders** 21
- **gmi frontier titanium base** 22
- **gmi frontier ball abutments** 23
- **gmi frontier multi-esthetic abutments** 24
- **gmi frontier bioesthetic bases** 27
- **gmi frontier replicas** 29
- **gmi frontier impression coping** 30
- **gmi frontier castables** 31
- **gmi frontier CrCo bases** 32
- **gmi frontier clinic and laboratory screws** 32
- **gmi frontier MEA and BE screws** 33
- Recommended tightening torques 34

### GMI SURGICAL KITS

- **gmi frontier/avantgard surgical kit** 37
- **gmi PEAK surgical kit** 38

### TECHNICAL SPECIFICATIONS




39

## Tratamiento superficial ADS®

### ADS® surface treatment

Para favorecer la adherencia y el crecimiento de las células óseas se ha tratado la superficie exterior del implante con el exclusivo sistema ADS® (Advanced Double-Grip Surface) que combina un microbululado con corindón blanco con un ataque ácido para obtener una rugosidad no uniforme, que maximiza la superficie de contacto entre el implante y el hueso y por tanto, mejora la estabilidad y la unión entre ellos.

To promote the adhesion and growth of bone cells, the outer surface of the implant has been treated with the exclusive ADS® treatment (Advanced Double-Grip Surface) which combines a white corundum micro-bubble treatment and acid etching, for a non-smooth roughness that maximizes the contact surface between implant and bone and therefore improves stability and adhesion between them.



El tratamiento ADS® es el resultado de una serie de colaboraciones con institutos y universidades, así como estudios y ensayos propios que nos permiten controlar y validar la respuesta biológica óptima de la superficie del implante: se han efectuado tanto estudios químicos (estudios de dispersión rayos X para conocer la composición del implante y su superficie) como topográficos (estudios de rugosidad), así como estudios biológicos (estudios de respuesta in vivo en animales) y estudios clínicos.


The ADS® treatment is the result of a series of collaborations with institutes and universities, as well as our own research and tests, that allow us to monitor and validate the optimal biological response to the implant surface: chemical (X-ray scattering studies to find out the composition of the implant and its surface) and topography studies (roughness studies) have been carried out, as well as biological (in vivo response studies in animals) and clinical studies.

## Estudios de composición

### Composition studies

Los estudios efectuados por dispersión de rayos X demuestran que sobre la superficie del implante solo se encuentra titanio y oxígeno, que son los componentes básicos de la capa de óxido que se forma en el proceso de pasivado del implante, y que es la que le confiere la excelente resistencia a la corrosión.

X-ray scattering studies show that the surface of the implants is only made of titanium and oxygen, which are the basic components of the oxide layer that is formed in the implant passivation process and that gives it its excellent corrosion resistance.

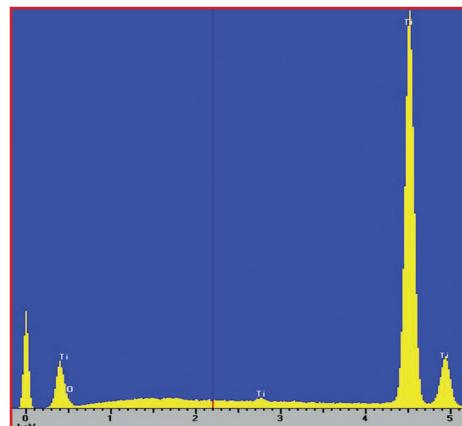


## Estudios de la topografía de la superficie

### Surface topography studies

Para controlar y conocer la topografía de la superficie del implante, se han efectuado estudios de rugosidad tanto con rugosímetros de contacto, como con técnicas SEM (Scanning Electron Microscope) y CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope), permitiéndonos obtener y controlar los valores de la media aritmética de la rugosidad ( $R_a$ ) dentro de los parámetros recomendados en las publicaciones internacionales.

In order to control and identify the topography of the implant surface, roughness studies were performed with profilometer, as well as with techniques such as SEM (Scanning Electron Microscope) and CLSM (Confocal Laser Scanning Microscope), allowing to obtain and control the mean roughness ( $R_a$ ) values within the parameters recommended in international publications.

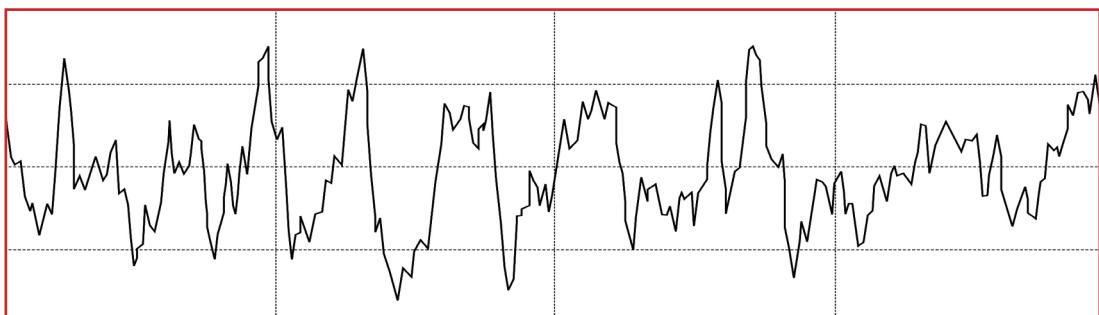




Perfil de rugosidad obtenido con HOMMEL-WERKE T1000 • Roughness profile obtained with HOMMEL-WERKE T1000.

## Estudios de osteointegración

### Osseointegration studies

Para conocer la respuesta biológica de los implantes gmi, se han efectuado estudios in vivo colocando los implantes en animales, dejándolos sin carga durante el proceso de cicatrización y efectuando un estudio histológico que demuestra la excelente respuesta de las células óseas y la osteointegración completa del implante.




To determine the biological response of gmi implants, in vivo studies were conducted by inserting the implants on animals, leaving them without load during the healing process and performing a histological study to prove the excellent response of the bone cells and the complete osseointegration of the implant.



SEM-BSE: detalles ultraestructurales de las células en biofilm sobre el implante. • SEM-BSE: Ultrastructural details of cells in biofilm on the implant.


## Recomendaciones de uso - Recommendations of use

La gama de implantes gmi modelo **frontier** ha sido diseñada y testada para ser colocada como restauración unitaria, con una inclinación máxima de 30 grados respecto al plano perpendicular al plano oclusal, según el siguiente diagrama.

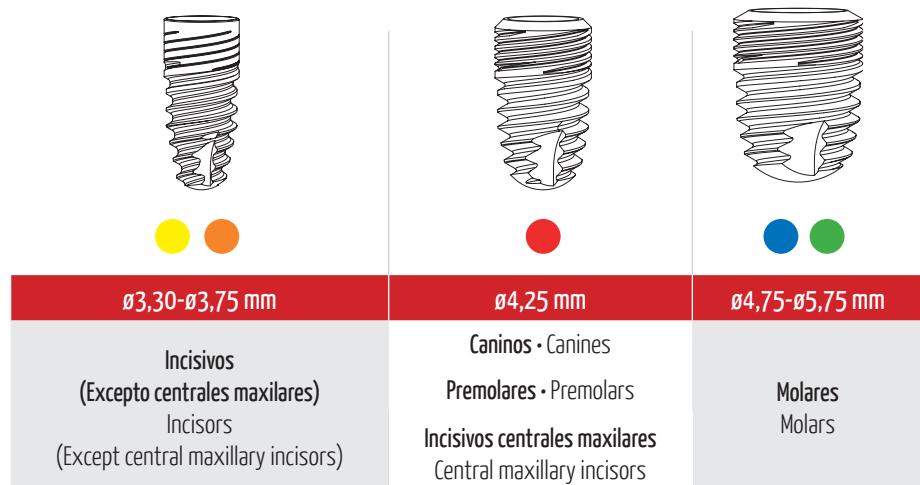


Los implantes gmi modelo **frontier** han sido diseñados para ser insertados aplicando un par de apriete de 35-40 N·cm, aunque pueden soportar un par máximo de apriete de 60 N·cm. gmi recomienda la inserción manual del implante con la llave de carraca dinamométrica para asegurar que no se sobrepasan estos valores.

The gmi frontier implant range is designed to be inserted applying a 35-40 N·cm torque, although it can bear a maximum tightening torque of 60 N·cm. gmi recommends manual insertion of the implant with a dynamometric ratchet wrench to ensure that these values are not exceeded.



La gama de implantes y aditamentos protésicos gmi modelo **frontier**, han sido diseñados y fabricados con unas tolerancias estudiadas para mantener unos ajustes que minimizan el juego entre los componentes, y por tanto garantizan la estabilidad de la conexión. gmi recomienda utilizar aditamentos originales para asegurar el perfecto ajuste entre los componentes de la restauración.

The gmi frontier range of implants and prosthetic attachments are designed and manufactured with tolerances intended to maintain adjustments that minimize the clearance between components and therefore guarantee the stability of the connection. gmi recommends the use of original attachments to ensure a perfect fit between the components of the restoration.



Para evitar deformaciones previas del tornillo clínica, gmi recomienda reservar su uso únicamente para el apriete definitivo de la prótesis. Para realizar los ajustes de la fase protésica se recomienda utilizar el tornillo laboratorio.

To prevent prior deformation of the clinic screw, gmi recommends restricting its use only for the final tightening of the prosthesis. To make adjustments during the prosthetic procedures, use of the laboratory screw is recommended.


## Descripción del etiquetado - Labelling description

En la tabla se detallan todos los símbolos que aparecen en las etiquetas y cajas del sistema de implantes gmi frontier, con su correspondiente descripción.


<b>1</b>	<b>REF</b>	Referencia - Reference
<b>2</b>	<b>LOT</b>	Número de Lote - Batch code
<b>3</b>		Fecha de caducidad - Used-by-date
<b>4</b>	<b>UDI</b>	Identificador único de producto Unique device identifier
<b>5</b>	<b>MD</b>	Dispositivo médico - Medical device
<b>6</b>		Fabricante - Manufacturer
<b>7</b>	<b>STERILE R</b>	Esterilizado usando radiación gamma Sterilized using gamma radiation
<b>8</b>		Sistema de barrera estéril único con embalaje de protección exterior Single sterile barrier system with protective packaging outside
<b>9</b>		De un solo uso - Single use only
<b>10</b>		No utilizar si el envase está dañado o abierto Do not use if packaging is damaged or opened
<b>11</b>		No reesterilizar - Do not resterilize
<b>12</b>		RM Condicional: los dispositivos no suponen ningún peligro conocido en un entorno RM específico con condiciones de uso concretas MR Conditional: Items do not pose any known hazards in a specific MR environment with specific conditions of use.
<b>13</b>		Fecha de fabricación Manufacturing date
<b>14</b>		Instrucciones de uso electrónicas* Electronic instructions for use*
<b>15</b>		Marco de conformidad europeo European conformity mark
<b>16</b>		Venta limitada a dentistas o médicos autorizados Sale by or on the order of a licensed dentist
<b>17</b>		No estéril - Non-sterile

In the chart are detailed all the symbols appearing on the gmi frontier implant system's labelling and packaging and their corresponding description.

Etiqueta implante - Implant label

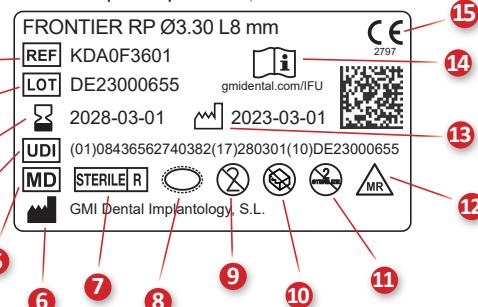

Etiqueta aditamentos - Attachments label

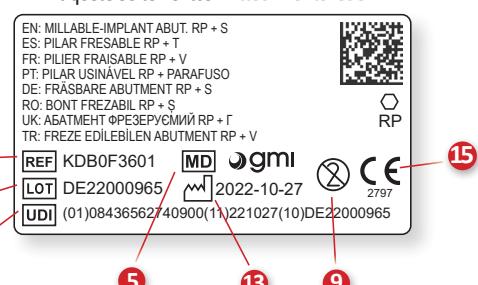

Caja - Packaging


Conexión y plataforma  
Connection and platform



Sobre aditamentos  
Attachments packaging



## Especificaciones del DataMatrix de las etiquetas - DataMatrix specifications of labels



- 01 - GTIN del producto etiquetado - Tagged product GTIN
- 17 - Fecha de caducidad (año/mes/día) - Used-by-date (year/month/day)
- 11 - Fecha de fabricación (año/mes/día) - Manufacturing date (year/month/day)
- 10 - Número de Lote - Batch code

\*Requisitos mínimos para abrir y descargar las instrucciones de uso electrónicas:

- Conectividad estable a internet.
- Un dispositivo con un sistema operativo moderno que admite la visualización de PDF.
- Espacio de almacenamiento adecuado en su dispositivo.
- Un navegador web como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge u Opera instalado en su dispositivo.
- Una aplicación de lectura de PDF instalada en su dispositivo.

\* Minimum requirements for downloading and opening the electronic instructions for use:

- Stable internet connectivity.
- A device with a modern operating system that supports PDF viewing.
- Adequate storage space on your device.
- A web browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge or Opera installed on your device.
- A PDF reader application installed on your device.



8

frontier

## Implantes dentales gmi frontier - gmi frontier dental implants

Los implantes de conexión interna hexagonal **gmi** modelo **frontier** están mecanizados en titanio grado IV c.p. de la máxima calidad, garantizando así una gran estabilidad química y por tanto una excelente bio-compatibilidad. La capa de dióxido de titanio, que se forma en la superficie del implante después del proceso de pasivado, y el estudiado diseño del perfil exterior de la rosca aseguran una buena osteointegración y una elevada estabilidad.


La rosca exterior de doble entrada del implante permite disminuir los tiempos quirúrgicos. Además, las formas redondeadas, los fresados auto-rosantes y la ligera conicidad apical facilitan la inserción del implante disminuyendo las tensiones producidas en la interfase hueso-implante, y por tanto evitando los problemas asociados al estrés de roscado.

**gmi frontier** internal connection hexagonal implants are machined in c.p. grade IV titanium of the highest quality, thus ensuring a high chemical stability and excellent biocompatibility. The titanium oxide layer, that is formed on the implant surface after the passivation process, and the careful design of the outer surface of the thread, guarantee good osseointegration and high stability.

The external dual inlet thread of the implant helps to reduce surgery time. Moreover, the rounded shapes, self-threading millings and slight tapering facilitate implant insertion, reducing tension at the bone-implant interface and thus preventing threading stress-related problems.

### Características generales

#### Key features

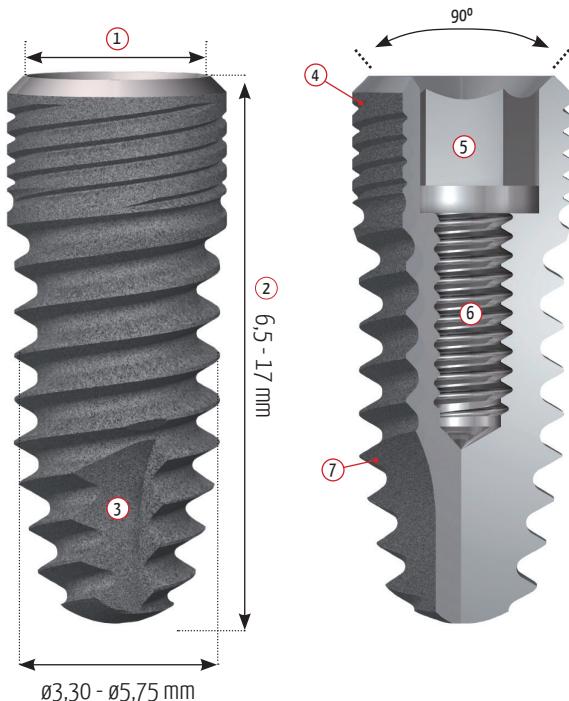

#### ① Plataformas

RP: estándar Ø3,30 mm  
WP: ancha Ø4,30 mm

#### ① Platforms

RP: Standard Ø3.30 mm  
WP: Wide Ø4.30 mm

#### ② Longitud

#### ② Length

#### ③ Fresados auto-rosantes

Longitud variable  
3 fresados a 120°  
Ápice atraumático

#### ③ Self threading millings

Variable length  
3 millings at 120°  
Atraumatic tip

#### ④ Rosca cortical

#### ④ Cortical thread

#### ⑤ Hexágono interno

E/C 2,45 mm x 1,50 mm

#### ⑤ Internal hexagon

B/F 2.45 mm x 1.50 mm

#### ⑥ Rosca interior

M1,8 x 0,35 mm

#### ⑥ Internal thread

M1.8 x 0.35 mm

#### ⑦ Cuerpo del implante

Paso: 1,60 mm

#### ⑦ Implant body

Pitch: 1.60 mm

	① RP	RP	RP	WP	WP
② De 8 a 15	From 8 to 15	De 8 a 17	De 6,5 a 17	De 6,5 a 13	De 6,5 a 13
④ Ø3,60		Ø4,00	Ø4,50	Ø5,00	Ø6,00
⑦ Ø3,30		Ø3,75	Ø4,25	Ø4,75	Ø5,75

## Protocolo de inserción de implantes gmi frontier - Insertion sequence for gmi frontier implants

Los implantes de conexión interna **gmi frontier** vienen presentados en una caja de cartón serigrafiada, en cuyo interior se encuentran las etiquetas de trazabilidad y un doble envase que contiene el sistema de implantes, siendo el envase secundario de plástico técnico y el envase primario de vidrio Pyrex para asegurar el comportamiento inerte del envase. Una vez envasados en sala blanca, son esterilizados mediante radiación gamma según normativa.

El nuevo sistema de envasado de los implantes **gmi frontier** consta de un soporte de titanio donde se aloja únicamente el implante dental preparado para ser introducido directamente en boca, utilizando una única llave transportador hex-2,45 mm, diseñada a tal efecto. Este nuevo sistema presenta las siguientes ventajas para el profesional: un mayor control y una mejor visibilidad del proceso de inserción del implante, una mayor facilidad de uso en espacios interdentales reducidos y una reducción en el tiempo de cirugía.\*

**gmi frontier** internal connection implants are packed in a screen-printed cardboard box, with the traceability labels and a double packaging containing the implant system, with the secondary packaging made of technical plastic and the primary packaging made of Pyrex glass to ensure the inert performance of the container. Once packaged in a clean room, they are sterilized with gamma radiation according to regulations.

The new packaging system of the **gmi frontier** implants consists of a titanium support which only houses the dental implant, prepared to be inserted directly into the mouth, using a single hex-2.45 mm implant carrier wrench, designed for this purpose. This new system offers the odontologist the following advantages: more control and a better view of the implant insertion process, it is easier to use in reduced interdental spaces and a reduction in surgery time.\*



\* Consultar las instrucciones de uso en formato electrónico.

1. Comprobar pegatina indicadora de diámetro y longitud del implante y abrir la caja de cartón.
2. Extraer el envase secundario y las etiquetas identificativas del producto.
3. Comprobar integridad del precinto de seguridad y desenroscar el tapón del envase secundario.
4. Extraer el envase primario del envase secundario evitando golpearlo contra una superficie rígida.
5. Extraer y guardar el tapón del envase primario, efectuando un movimiento lateral.
6. Introducir la llave-transportador HEX-2,45 mm hasta notar una ligera retención, encarando el hexágono de la llave con las caras del hexágono del implante.
7. Comprobar que la llave está totalmente insertada y efectuar un pequeño giro mientras se estira con suavidad el conjunto.
8. Colocar el implante en el lecho óseo aplicando un par de 35 N·cm hasta que la parte tratada quede a nivel crestal o subcrestal. Extraer la llave.
9. Extraer el tapón de cierre del tapón primario, utilizando la llave de HEX-1,20 mm.
10. Roscar el tapón de cierre al implante aplicando un par máximo de 15 N·cm. Extraer llave y suturar incisión.

\* Consult the instructions for use in electronic format.

1. Check sticker indicating implant diameter and length and open the carton.
2. Remove the secondary packaging and product identification labels.
3. Check the integrity of the safety seal and unscrew the plug on the secondary packaging.
4. Remove the primary packaging from the secondary packaging avoiding hitting it against a hard surface.
5. Extract and save the primary packaging plug making a lateral movement.
6. Insert the HEX-2.45 mm implant carrier wrench until a slight retention is noticed, addressing the hex of the key with the faces of the implant hex broaching.
7. Check that the key is fully inserted and turn slightly while gently pulling on the assembly.
8. Place the implant in the bone bed by applying a torque of 35 N·cm until the treated area is at the crestal or subcrestal level. Remove the key.
9. Remove the cover screw from the primary packaging plug, using the HEX-1.20 mm wrench.
10. Screw the cover screw to the implant by applying a maximum torque of 15 N·cm. Remove key and suture the incision.

## Gama de implantes gmi frontier - gmi frontier implants range



**Implantes frontier ø3,30 mm plataforma RP**  
frontier ø3.30 implants with RP platform

L (mm)	Ref.
8,00	KDAoF3601
10,00	KDAoF3602
11,50	KDAoF3603
13,00	KDAoF3604
15,00	KDAoF3605



**Implantes frontier ø3,75 mm plataforma RP**  
frontier ø3.75 implants with RP platform

L (mm)	Ref.
8,00	KDAoF3606
10,00	KDAoF3607
11,50	KDAoF3608
13,00	KDAoF3609
15,00	KDAoF3610
17,00	KDAoF3611



**Implantes frontier ø4,25 mm plataforma RP**  
frontier ø4.25 implants with RP platform

L (mm)	Ref.
6,50	KDAoF3630
8,00	KDAoF3612
10,00	KDAoF3613
11,50	KDAoF3614
13,00	KDAoF3615
15,00	KDAoF3616
17,00	KDAoF3617

## Gama de implantes gmi frontier - gmi frontier implants range

frontier



### Implantes frontier ø4,75 mm plataforma WP frontier ø4.75 implants with WP platform

L (mm)	Ref.
6,50	KDAOF3631
8,00	KDAOF3622
10,00	KDAOF3623
11,50	KDAOF3624
13,00	KDAOF3625



### Implantes frontier ø5,75 mm plataforma WP frontier ø5.75 implants with WP platform

L (mm)	Ref.
6,50	KDAOF3632
8,00	KDAOF3626
10,00	KDAOF3627
11,50	KDAOF3628
13,00	KDAOF3629

## Secuencias fresado para implantes gmi frontier - Drilling sequences for gmi frontier implants

A continuación se describen las secuencias de fresado para los diferentes modelos de implantes de conexión interna y las condiciones de corte aconsejadas para su uso:


- Fresa lanza: 1200 - 1500 rpm.
- Fresa Piloto: 700 - 900 rpm.
- Fresas escalonadas:
  - $\varnothing 3.00$  y  $\varnothing 3.50$  mm → 400 - 700 rpm.
  - $\varnothing 4.00$  y  $\varnothing 5.10$  mm → 400 - 600 rpm.
- Fresas corticales: 200 - 400 rpm.

Para fresar es necesario disponer de refrigeración externa con solución salina.

The following is a description of the drilling sequences for the different internal connection implant models, as well as the recommended drilling conditions for their use:


- Lance-shaped drill: 1200 - 1500 rpm.
- Pilot drill: 700 - 900 rpm.
- Step drills:
  - $\varnothing 3.00$  &  $\varnothing 3.50$ mm → 400 - 700 rpm.
  - $\varnothing 4.00$  &  $\varnothing 5.10$ mm → 400 - 600 rpm.
- Cortical drills: 200 - 400 rpm.

For drilling, external cooling with saline solution is required.

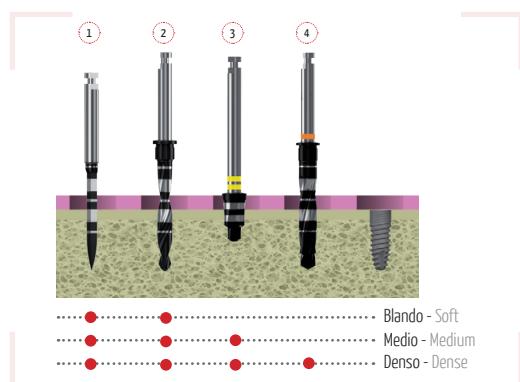

### frontier Ø3,30

Descripción - Description		Ref.
1 Fresa lanza	Lance-shaped drill	KYFOC1225
2 Fresa piloto Ø2.50	Pilot drill Ø2.50	KYFOC2250
3 Fresa cortical Ø3,65	Cortical drill Ø3.65	KYFOC4336
4 Fresa escalonada Ø2,50/Ø3,00	Step drill Ø2.50/Ø3.00	KYFOC5130

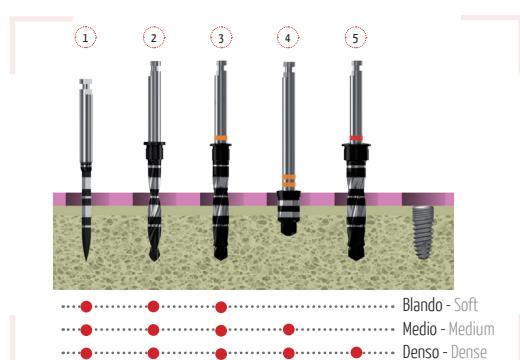


### frontier Ø3,75


Descripción - Description		Ref.
1 Fresa lanza	Lance-shaped drill	KYFOC1225
2 Fresa piloto Ø2,50	Pilot drill Ø2.50	KYFOC2250
3 Fresa escalonada Ø2,50/Ø3,00	Step drill Ø2.50/Ø3.00	KYFOC5130
4 Fresa cortical Ø4,00	Cortical drill Ø4.00	KYFOC4340
5 Fresa escalonada Ø3,00/Ø3,50	Step drill Ø3.00/Ø3.50	KYFOC5135

## Secuencias fresado para implantes gmi frontier - Drilling sequences for gmi frontier implants


frontier

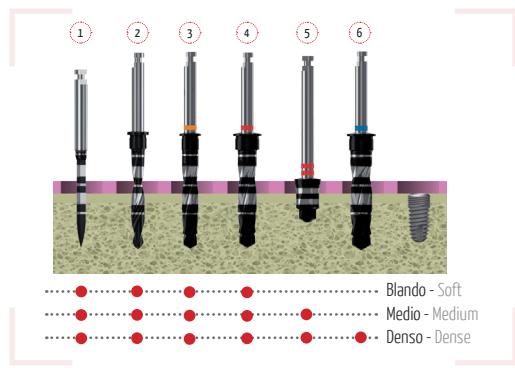

frontier Ø4,25		
	Descripción - Description	Ref.
1	Fresa lanza	Lance-shaped drill
2	Fresa piloto Ø2,50	Pilot drill Ø2.50
3	Fresa escalonada Ø2,50/Ø3,00	Step drill Ø2.50/Ø3.00
4	Fresa escalonada Ø3,00/Ø3,50	Step drill Ø3.00/Ø3.50
5	Fresa cortical Ø4,50	Cortical drill Ø4.50
6	Fresa escalonada Ø3,50/Ø4,00	Step drill Ø3.50/Ø4.00

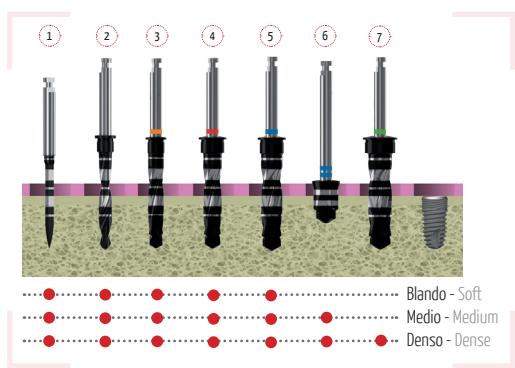

frontier Ø4,75		
	Descripción - Description	Ref.
1	Fresa lanza	Lance-shaped drill
2	Fresa piloto Ø2,50	Pilot drill Ø2.50
3	Fresa escalonada Ø2,50/Ø3,00	Step drill Ø2.50/Ø3.00
4	Fresa escalonada Ø3,00/Ø3,50	Step drill Ø3.00/Ø3.50
5	Fresa escalonada Ø3,50/Ø4,00	Step drill Ø3.50/Ø4.00
6	Fresa cortical Ø4,90	Cortical drill Ø4.90
7	Fresa escalonada Ø4,00/Ø4,50	Step drill Ø4.00/Ø4.50

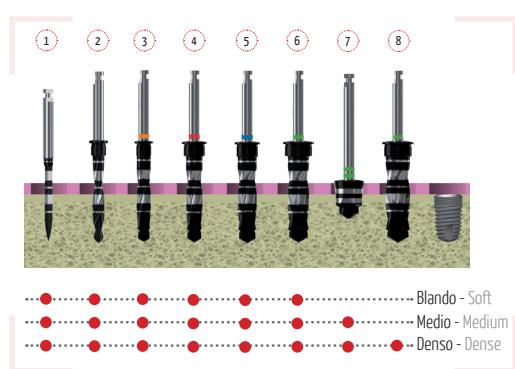

frontier Ø5,75		
	Descripción - Description	Ref.
1	Fresa lanza	Lance-shaped drill
2	Fresa piloto Ø2,50	Pilot drill Ø2.50
3	Fresa escalonada Ø2,50/Ø3,00	Step drill Ø2.50/Ø3.00
4	Fresa escalonada Ø3,00/Ø3,50	Step drill Ø3.00/Ø3.50
5	Fresa escalonada Ø3,50/Ø4,00	Step drill Ø3.50/Ø4.00
6	Fresa escalonada Ø4,00/Ø4,50	Step drill Ø4.00/Ø4.50
7	Fresa cortical Ø5,90	Cortical drill Ø5.90
8	Fresa escalonada Ø4,50/Ø5,10	Step drill Ø4.50/Ø5.10



## Implantes dentales gmi frontier PEAK - gmi frontier PEAK dental implants

Los implantes de conexión interna hexagonal gmi modelo frontier PEAK están mecanizados en titanio grado IV c.p. de la máxima calidad, garantizando así una gran estabilidad química y por tanto una excelente bio-compatibilidad. La capa de dióxido de titanio, que se forma en la superficie del implante después del proceso de pasivado, y el estudiado diseño del perfil exterior de la rosca aseguran una buena osteointegración y una elevada estabilidad.


La rosca exterior de doble entrada del implante permite disminuir los tiempos quirúrgicos. Además, el núcleo cónico y el perfil de rosca progresiva facilitan la inserción del implante y actúan como un compactador óseo permitiendo obtener una elevada estabilidad primaria en huesos poco densos.

gmi frontier PEAK internal connection hexagonal implants are machined in c.p. grade IV titanium of the highest quality, thus ensuring a high chemical stability and excellent biocompatibility. The titanium oxide layer, that is formed on the implant surface after the passivation process, and the careful design of the outer surface of the thread, guarantee good osseointegration and high stability.

The external dual inlet thread of the implant helps to reduce surgery time. Moreover, the conical core and progressive thread profile facilitate implant insertion and act as a bone compactor allowing high primary stability to be obtained in sparse bones.

### Características generales

#### Key features

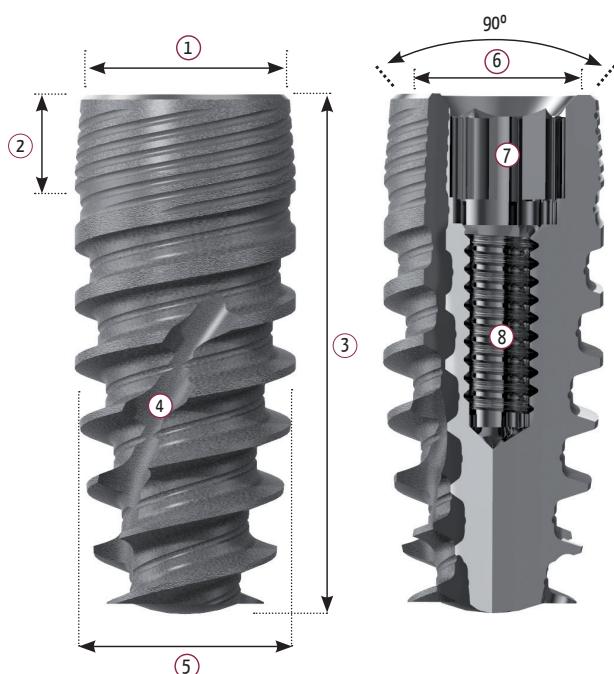

① Ø plataforma

① Platform Ø

② Rosca cortical

② Cortical thread  
1.50 mm

③ Longitud

③ Length

④ Fresados auto-rosantes

④ Self threading millings  
Variable length  
2 fresados a 180°  
Ápice atraumático  
Corte en ambas direcciones

⑤ Cuerpo del implante  
Paso: 2,40 mm

⑤ Implant body  
Pitch: 2.40 mm

⑥ Conexión

⑥ Connection  
RP: standard Ø3,30 mm

⑦ Hexágono interno  
E/C 2,45 mm x 1,50 mm

⑦ Internal hexagon  
B/F 2.45 mm x 1.50 mm

⑧ Rosca interior  
M1,8 x 0,35 mm

⑧ Internal thread  
M1.8 x 0.35 mm

①	Ø3,70	Ø4,00	Ø4,30
③	De 8 a 15	De 6,5 a 13	De 6,5 a 13
⑤	From 8 to 15	From 6.5 to 13	From 6.5 to 13
⑥	RP	RP	RP

## Protocolo de inserción de implantes gmi frontier PEAK - Insertion sequence for gmi frontier PEAK implants

Los implantes de conexión interna **gmi frontier PEAK** vienen presentados en una caja de cartón serigrafiada, en cuyo interior se encuentran las etiquetas de trazabilidad y un doble envase que contiene el sistema de implantes, siendo el envase secundario de plástico técnico y el envase primario de vidrio Pyrex para asegurar el comportamiento inerte del envase. Una vez envasados en sala blanca, son esterilizados mediante radiación gamma según normativa.

El nuevo sistema de envasado de los implantes **gmi frontier PEAK** consta de un soporte de titanio donde se aloja únicamente el implante dental preparado para ser introducido directamente en boca, utilizando una única llave transportador hex-2,45 mm, diseñada a tal efecto. Este nuevo sistema presenta las siguientes ventajas para el profesional: un mayor control y una mejor visibilidad del proceso de inserción del implante, una mayor facilidad de uso en espacios interdentales reducidos y una reducción en el tiempo de cirugía.\*

**gmi frontier PEAK** internal connection implants are packed in a screen-printed cardboard box, with the traceability labels and a double packaging containing the implant system, with the secondary packaging made of technical plastic and the primary packaging made of Pyrex glass to ensure the inert performance of the container. Once packaged in a clean room, they are sterilized with gamma radiation according to regulations.

The new packaging system of the **gmi frontier PEAK** implants consists of a titanium support which only houses the dental implant, prepared to be inserted directly into the mouth, using a single hex-2.45 mm implant carrier wrench, designed for this purpose. This new system offers the odontologist the following advantages: more control and a better view of the implant insertion process, it is easier to use in reduced interdental spaces and a reduction in surgery time.\*



\* Consultar las instrucciones de uso en formato electrónico.

1. Comprobar pegatina indicadora de diámetro y longitud del implante y abrir la caja de cartón.
2. Extraer el envase secundario y las etiquetas identificativas del producto.
3. Comprobar integridad del precinto de seguridad y desenroscar el tapón del envase secundario.
4. Extraer el envase primario del envase secundario evitando golpearlo contra una superficie rígida.
5. Extraer y guardar el tapón del envase primario, efectuando un movimiento lateral.
6. Introducir la llave-transportador HEX-2,45 mm hasta notar una ligera retención, encarando el hexágono de la llave con las caras del hexágono del implante.
7. Comprobar que la llave está totalmente insertada y efectuar un pequeño giro mientras se estira con suavidad el conjunto.
8. Colocar el implante en el lecho óseo aplicando un par de 35 N-cm hasta que la parte tratada quede a nivel crestal o subcrestal. Extraer la llave.
9. Extraer el tapón de cierre del tapón primario, utilizando la llave de HEX-1,20 mm.
10. Roscar el tapón de cierre al implante aplicando un par máximo de 15 N-cm. Extraer llave y suturar incisión.

\* Consult the instructions for use in electronic format.

1. Check sticker indicating implant diameter and length and open the carton.
2. Remove the secondary packaging and product identification labels.
3. Check the integrity of the safety seal and unscrew the plug on the secondary packaging.
4. Remove the primary packaging from the secondary packaging avoiding hitting it against a hard surface.
5. Extract and save the primary packaging plug making a lateral movement.
6. Insert the HEX-2.45 mm implant carrier wrench until a slight retention is noticed, addressing the hex of the key with the faces of the implant hex broaching.
7. Check that the key is fully inserted and turn slightly while gently pulling on the assembly.
8. Place the implant in the bone bed by applying a torque of 35 N-cm until the treated area is at the crestal or subcrestal level. Remove the key.
9. Remove the cover screw from the primary packaging plug, using the HEX-1.20 mm wrench.
10. Screw the cover screw to the implant by applying a maximum torque of 15 N-cm. Remove key and suture the incision.

## Gama de implantes gmi frontier PEAK - gmi frontier PEAK implants range



### **Implantes frontier PEAK ø3,75 mm plataforma RP** frontier PEAK ø3.75 implants with RP platform

L (mm)	Ref.
8,00	KDAoF3801
10,00	KDAoF3802
11,50	KDAoF3803
13,00	KDAoF3804
15,00	KDAoF3815



### **Implantes frontier PEAK ø4,25 mm plataforma RP** frontier PEAK ø4.25 implants with RP platform

L (mm)	Ref.
6,50	KDAoF3805
8,00	KDAoF3806
10,00	KDAoF3807
11,50	KDAoF3808
13,00	KDAoF3809



### **Implantes frontier PEAK ø4,75 mm plataforma RP** frontier PEAK ø4.75 implants with RP platform

L (mm)	Ref.
6,50	KDAoF3810
8,00	KDAoF3811
10,00	KDAoF3812
11,50	KDAoF3813
13,00	KDAoF3814

## Secuencias fresado para implantes gmi frontier PEAK - Drilling sequences for gmi frontier PEAK implants

A continuación se describen las secuencias de fresado para los diferentes modelos de implantes de conexión interna y las condiciones de corte aconsejadas para su uso:

- Fresa bola e inicial: 1000 rpm.

- Fresas escalonadas y cónicas:

- |  |                  |
|--|------------------|
| $\varnothing 2,00 / \varnothing 2,80$ mm | → 500 - 700 rpm. |
| $\varnothing 3,20 / \varnothing 3,65$ mm | → 500 - 700 rpm. |
| $\varnothing 3,70 / \varnothing 4,15$ mm | → 400 - 700 rpm. |
| $\varnothing 4,15 / \varnothing 4,65$ mm | → 400 - 600 rpm. |

- Fresas corticales: 200 - 400 rpm.

Para fresar es necesario disponer de refrigeración externa con solución salina.

The following is a description of the drilling sequences for the different internal connection implant models, as well as the recommended drilling conditions for their use:


- Ball and initial drill: 1000 rpm.

- Step and conical drills:


- |  |                  |
|--|------------------|
| $\varnothing 2,00 / \varnothing 2,80$ mm | → 500 - 700 rpm. |
| $\varnothing 3,20 / \varnothing 3,65$ mm | → 500 - 700 rpm. |
| $\varnothing 3,70 / \varnothing 4,15$ mm | → 400 - 700 rpm. |
| $\varnothing 4,15 / \varnothing 4,65$ mm | → 400 - 600 rpm. |

- Cortical drills: 200 - 400 rpm.


For drilling, external cooling with saline solution is required.

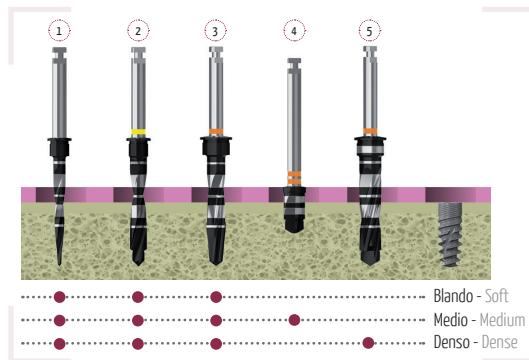

frontier PEAK Ø3,75		
	Descripción - Description	Ref.
1	Fresa inicial	Initial drill
2	Fresa escalonada Ø2,00/Ø2,80 mm	KYFOC1401
3	Fresa cónica Ø3,20 mm	KYFOC5128
4	Fresa cortical Ø3,65 mm	KYFOC7032
5	Fresa escalonada Ø3,20/Ø3,65mm	Cortical drill Ø3.65
		KYFOC4337
		KYFOC5137

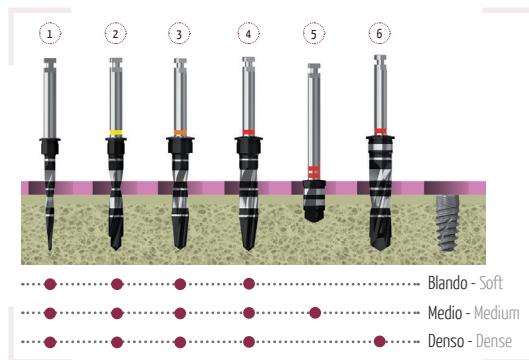

frontier PEAK Ø4,25		
	Descripción - Description	Ref.
1	Fresa inicial	Initial drill
2	Fresa escalonada Ø2,00/Ø2,80 mm	KYFOC1401
3	Fresa cónica Ø3,20 mm	KYFOC5128
4	Fresa cónica Ø3,70 mm	Conical drill Ø3.20 mm
5	Fresa cortical Ø4,15 mm	Conical drill Ø3.70 mm
6	Fresa escalonada Ø3,70/Ø4,15mm	Cortical drill Ø4.15 mm
		KYFOC4342
		KYFOC5142

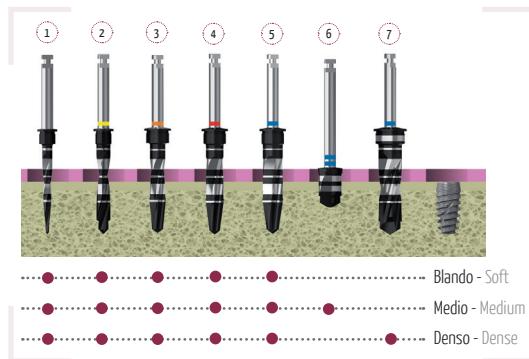

frontier PEAK Ø4,75		
	Descripción - Description	Ref.
1	Fresa inicial	Initial drill
2	Fresa escalonada Ø2,00/Ø2,80 mm	KYFOC1401
3	Fresa cónica Ø3,20 mm	KYFOC5128
4	Fresa cónica Ø3,70 mm	Conical drill Ø3.20 mm
5	Fresa cortical Ø4,20 mm	Conical drill Ø3.70 mm
6	Fresa escalonada Ø4,20/Ø4,65mm	Cortical drill Ø4.20 mm
		KYFOC4347
7	Fresa escalonada Ø4,15/Ø4,65mm	Step drill Ø4.15/Ø4.65mm
		KYFOC5147

## Pilares de cicatrización gmi frontier - gmi frontier healing abutments

Una vez finalizada la fase de reparación de los tejidos de sostén del implante, en el caso de implantes cubiertos total o parcialmente por tejido blando, debe existir un canal o túnel mucoso que permita la conexión del implante a la estructura secundaria o prótesis. Los pilares de cicatrización son los encargados de formar esta vía mucosa una vez se ha abierto por incisión el tejido blando, se ha retirado el tapón de cierre y han sido roscados al implante.

### Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Apriete con llave hexagonal de e/c 1,20 mm.
- Apriete alternativo con destornillador de punta plana.
- Disponibles en alturas de emergencia de 2,00 a 6,00 mm.
- Mecha apical para facilitar el inicio de roscado.

Once the repair phase of the tissue supporting the implant has finished, in the case of implants fully or partially covered by soft tissue there must be a mucosal channel or tunnel enabling connection of the implant to the prosthesis or secondary structure. Healing abutments are used to form the mucosal route, once the soft tissue has been opened by incision and the cover screw has been withdrawn, by screwing them to the implant.

### Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Tightening with b/f 1.20 mm hex wrench.
- Alternative tightening with a flat tip screwdriver.
- Available in emergency heights from 2.00 to 6.00 mm.
- Apical bit to facilitate the start of threading.



Pilares cicatrización - Healing abutments				
Plataforma Platform	Ø cabeza Ø head	h	h gingival	Ref.
RP ●●	Ø 4,00	2,00	1,00	KDPOC3601
		3,00	2,00	KDPOC3602
		4,00	3,00	KDPOC3603
		5,00	4,00	KDPOC3604



Pilares cicatrización anatómicos - Anatomical healing abutments				
Plataforma Platform	Ø cabeza Ø head	h	h gingival	Ref.
RP ●●	Ø 5,00	3,00	1,50	KDPOC3609 ①
		3,00	1,50	KDPOC3617 ②
		4,00	2,50	KDPOC3618 ②
		5,00	3,50	KDPOC3619 ②
		6,00	4,50	KDPOC3620 ②



Pilares cicatrización - Healing abutments				
Plataforma Platform	Ø cabeza Ø head	h	h gingival	Ref.
WP ●	Ø 5,00	2,00	1,00	KDPOC3605
		3,00	2,00	KDPOC3606
		4,00	3,00	KDPOC3607
		5,00	4,00	KDPOC3608

## Pilares de cicatrización gmi frontier - gmi frontier healing abutments



Pilares cicatrización anatómicos - Anatomical healing abutments				
Plataforma Platform	Ø cabeza Ø head	h	h gingival	Ref.
WP ●	Ø 6,00	3,00	1,50	KDPOC3613 ①
		3,00	1,50	KDPOC3621 ②
		4,00	2,50	KDPOC3622 ②
		5,00	3,50	KDPOC3623 ②
		6,00	4,50	KDPOC3624 ②

## Pilares fresables gmi frontier - gmi frontier millable-implant abutments

Cuando sea necesario utilizar un pilar a medida se utilizarán los pilares fresables, que permitirán, mediante el corte en cualquier dirección, adecuarse a las necesidades del protésico. Además y como función complementaria, los pilares fresables pueden ser utilizados como toma de impresión, rosándolos al implante mediante el tornillo de impresión corto y utilizándolos para hacer el negativo de la boca del paciente y su posterior positivación en escayola.


When the use of a custom abutment is required, millable abutments can be used. By cutting them in any direction, they can be suited to the needs of the prosthetic. In addition and as a complementary function, millable implant abutments can be used like impression coping, threading them to the implant screw through the short impression screw and using them to make the negative of the patient's mouth for subsequent positivation on plaster.

### Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Permiten corte en cualquier dirección adecuándose a las necesidades protésicas.
- Compatibles con llave hexagonal de e/c 4,00 mm para utilizar como transportador.
- Disponibles sólo en versión anti-rotatoria.
- Posibilidad de utilizarlos como toma de impresión con tornillo impresión corto.
- Incluye tornillo clínica ref: KDToc3601.

### Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- They allow cutting in any direction to suit the needs of the prosthetic.
- Compatible with b/f 4.00 mm hex wrench for use as an implant carrier.
- Available only in non-rotary version.
- Possibility to use as impression coping with short impression screw.
- Clinic screw ref.: KDToc3601 included.

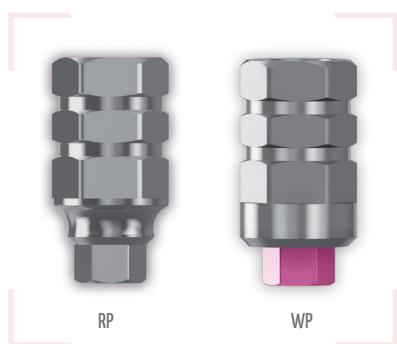



Plataforma Platform	Ref.
RP ●●	KDBoF3603
WP ●	KDBoF3602

## Pilares inclinados gmi frontier - gmi frontier angled abutments

Cuando es necesario corregir una posición angular extrema del implante en el interior de la estructura ósea, en relación a las piezas naturales o implantes adyacentes, se utilizarán los pilares inclinados que, una vez montados y orientados sobre el implante, permitirán la paralelización de la nueva corona con el resto de estructuras.

### Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Permiten corregir disparalelosismos de hasta 20 grados.
- Incluye tornillo clínica ref: KDT0C3601.
- Hombro del pilar adaptado a la forma de la encía.

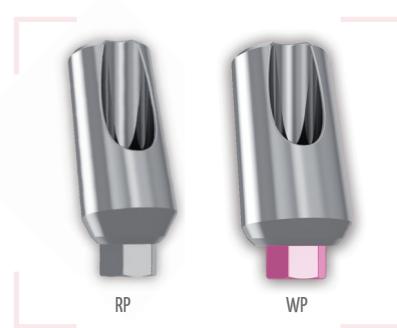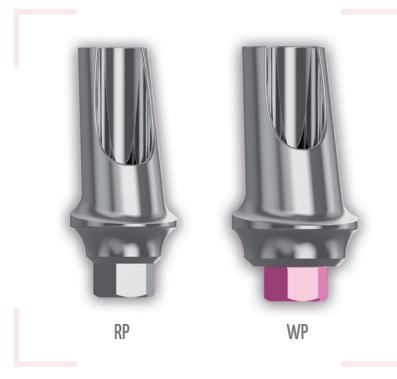

When it is necessary to correct an extreme angular position of the implant inside the bone structure in relation to adjacent natural or prosthetic teeth, angled abutments should be used. Once mounted and oriented on the implant, these abutments will allow the parallelization of the new crown with other structures.

### Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Allow non-parallelism correction up to 20 degrees.
- Clinic screw ref: KDT0C3601 included.
- Abutment shoulder adapted to the shape of the gum.

Pilares inclinados estéticos Esthetic angled abutments		
Plataforma Platform	Ang. (º)	Ref.
RP ●●	15º	KDM0F3634
	20º	KDM0F3635
WP ●	15º	KDM0F3636
	20º	KDM0F3637

Pilares inclinados Angled abutments		
Plataforma Platform	Ang. (º)	Ref.
RP ●●	20º	KDM0F3613
WP ●	20º	KDM0F3614

## Pilares rectos gmi frontier - gmi frontier straight abutments

Una vez formado el túnel mucoso por el pilar de cicatrización y retirado este de su localización, se procede a utilizar el pilar correspondiente, que se define como el aditamento mecanizado cónico que una vez fijado con el tornillo clínica a la parte superior del implante sirve de soporte para la corona clínica fijándose a ésta mediante la utilización de cemento.

### Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Planos anti-rotatorios para facilitar la retención.
- Versión anti-rotatoria hexagonal e/c 2,45 mm.
- Tornillo clínica incluido ref: KDT0C3601.
- Disponibles en tres alturas de emergencia de 1,50 a 3,50 mm.

Once the mucosal tunnel has been formed by the healing abutment and after removing it from this location, it is appropriate to use the abutment, which is defined as the machined tapered attachment that, after being fixed with the clinic screw to the top of the implant, acts as a support for the clinic crown and is attached to it using cement.

### Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Anti-rotational planes to increase retention.
- Abutments in b/f 2.45 mm hex non-rotary version.
- Clinic screw ref: KDT0C3601 included.
- Available in three emergency heights from 1.50 to 3.50 mm.

## Pilares rectos gmi frontier - gmi frontier straight abutments



Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP ●●	1,50	KDMoF3628
	2,50	KDMoF3629
	3,50	KDMoF3630



Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
WP ●	1,50	KDMoF3631
	2,50	KDMoF3632
	3,50	KDMoF3633

## Pilares provisionales rectos gmi frontier - gmi frontier straight temporary cylinders

Cuando es necesario efectuar una restauración mientras se consolida la interfase hueso-implante se utilizan los pilares provisionales, que se definen como los aditamentos mecanizados en plástico técnico que, una vez fijados a la parte coronal del implante mediante el tornillo clínica, absorberán la mayoría de los esfuerzos de masticación evitando sobrecargar el implante mientras finaliza el proceso de osteointegración.

### Características principales

- Mecanizado en plástico técnico de alta resiliencia.
- Hombro del pilar adaptado a la forma de la encía.
- Plano anti-rotatorio y regatas transversales para facilitar la retención.
- Tornillo clínica incluido ref: KDT0C3601

When it is necessary to perform a provisional restoration while the bone-implant interfaces or the soft tissues are healing, the temporary cylinder is used, defined as technical plastic machined attachment that once attached to the crown of the implant with clinic screw, will absorb most of the masticatory stresses while avoiding overloading the implant while the osseointegration process is completed.

### Key features

- Machined in high strength technical plastic.
- Abutment shoulder adapted to the shape of the gum.
- Anti-rotational plane and transverse retention to provide good fixation.
- Clinic screw ref.: KDT0C3601 included.



Plataforma Platform	Tipo conexión Connection type	Ref.
RP ●●	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDHoF3605
	Rotatoria • Rotary	KDHoF3607
WP ●	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDHoF3606
	Rotatoria • Rotary	KDHoF3608




## Base titanio gmi frontier - gmi frontier titanium base

Una vez formado el túnel mucoso por el pilar de cicatrización y retirado este de su localización, se procede a utilizar la base de titanio correspondiente, que se define como el aditamento mecanizado cónico que una vez fijado con el tornillo clínica a la parte superior del implante sirve de soporte para una meso-estructura metálica o cerámica ya sea colada o mecanizada mediante CAD/CAM.

### Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Versión anti-rotatoria y rotatoria.
- Tornillo clínica incluido ref: KDT0C3601.
- Disponible en alturas de emergencia de 0,60 mm, 1,50 mm y 3,00 mm.
- Elemento anti-giro en base anti-rotatoria que permite indexación.
- Escaneo directo sobre la Base de titanio o escaneo alternativo sobre el Pilar de escaneo.

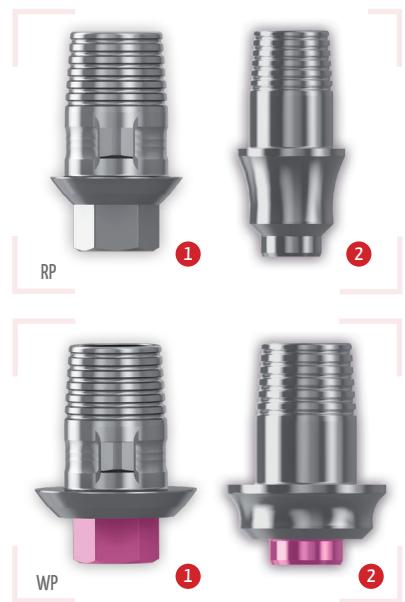

Once the mucosal tunnel has been formed by the healing abutment and after removing the cap from this location, it is appropriate to use the titanium base, which is defined as the machined tapered attachment that, after being fixed with the clinic screw to the top of the implant, acts as a support for a metallic or ceramic meso-structure casted or machined with CAD/CAM.

### Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Non-rotary and rotary version.
- Clinic screw ref: KDT0C3601 included.
- Available in emergency heights of 0.60 mm, 1.50 mm and 3.00 mm.
- Non-rotary titanium base with indexation.
- Scan directly on Titanium base or alternative scan on Scan abutment.


Base titanio - Titanium base			
Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Tipo conexión Connection type	Ref.
RP	0,65*	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDM0F3615 ①
	0,65*	Rotatoria • Rotary	KDM0F3616 ①
	1,50	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDM0F3638 ②
	1,50	Rotatoria • Rotary	KDM0F3640 ②
	3,00	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDM0F3639 ②
	3,00	Rotatoria • Rotary	KDM0F3641 ②
WP	0,65*	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDM0F3617 ①
	0,65*	Rotatoria • Rotary	KDM0F3618 ①
	1,50	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDM0F3642 ②
	1,50	Rotatoria • Rotary	KDM0F3644 ②
	3,00	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDM0F3643 ②
	3,00	Rotatoria • Rotary	KDM0F3645 ②

\* Utilizar el Pilar de cicatrización h=3 mm RP (KDP0C3609) y WP (KDP0C3613)  
\* Use the Healing abutment h=3 mm RP (KDP0C3609) and WP (KDP0C3613)



Calcinable - Castable			
Plataforma Platform	Altura total (mm) Total Height (mm)	Cantidad (Ud.) Quantity (Un.)	Ref.
RP	11,00	10	KDC0F3605
WP	11,00	10	KDC0F3606

## Base titanio gmi frontier - gmi frontier titanium base



### Pilar escaneado - Scanabutment

Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP ●●	5,30	KDlOf3601
WP ●	5,30	KDlOf3602

### Cuerpo pilar escaneado - Scanbody

Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP - WP ●●	7,50	KDlOf4003

### Scanbody de titanio - Titanium scanbody

Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP ●●	11,20	KDlOf3603
WP ●	11,20	KDlOf3604

## Pilares bola gmi frontier - gmi frontier ball abutments

Una vez formado el túnel mucoso por el pilar de cicatrización, y retirado este de su localización, se procede a utilizar el pilar bola correspondiente, que se define como el aditamento mecanizado que una vez fijado a la parte superior del implante sirve de elemento retentivo de la prótesis removible, la cual lleva incorporados previamente los casquillos de retención que se fijarán en la parte esférica superior de los pilares bola.

Once the healing abutment has formed the mucosal tunnel and the healing abutment has been removed from this location, the corresponding ball abutment is used, which is defined as a machined attachment being fixed to the top of the implant and serving as the retention element for the removable prosthesis, with the previous addition of the retention caps that will be fixed to the top spherical part of the ball abutment.

### Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Disponibles en alturas de emergencia de 1,00 a 4,00 mm.
- Cofia de retención rosa y contenedor incluidos.
- Disco de protección incluido.
- Apriete con llave hexagonal de e/c 2,45 mm ref: KYlOf0065.
- Instrumental para cofias: Insertador / extractor de cofias (RH485IC).

### Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Available in emergency heights from 1.00 to 4.00 mm.
- Pink retention cap and metal container included.
- Protection disk included.
- Tightening with b/f 2.45 mm hex wrench, part no.: KYlOf0065.
- Instruments for caps: Insertion / removal tool for caps (RH485IC).



Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP ●●	1,00	KDlOf3609
	2,00	KDlOf3610
	3,00	KDlOf3611
	4,00	KDlOf3612

## Pilares bola gmi frontier - gmi frontier ball abutments



Retenciones Retention caps				
Tipo retención Retainer type	Color	Cantidad (ud.) Quantity (Un)	Ref.	
Suave • Soft (900 gr)	Rosa • Pink	6	RH40CRNSN	
Fuerte • Strong (1300 gr)	Verde • Green	6	RH040CRN	
Elástica • Elastic (500 gr)	Naranja • Orange	6	RH049PCN	

Contenedor cofias Metal container	
Cantidad (ud.) Quantity (Un)	Ref.
2	RH041CANB

Discos protección Protection disks	
Cantidad (ud.) Quantity (Un)	Ref.
10	RH100PD

## Pilares multi-estético gmi frontier - gmi frontier multi-esthetic abutments

Una vez efectuada la primera etapa de la cirugía, y por tanto obtenida la osteointegración del implante, se procede a utilizar el pilar multi-estético (PME), que se define como el aditamento mecanizado que una vez fijado a la parte coronal del implante sirve como soporte de una restauración múltiple, disminuyendo la altura entre la conexión del implante y la conexión de la estructura, y facilitando el ajuste pasivo de la estructura.

### Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Disponibles en alturas de emergencia de 1,00 a 4,50 mm.
- Pilares rectos de una sola pieza en versión rotatoria.
- Apriete con llaves hexagonales:  
RP: E/C 2,00 mm (KYLoCo149)  
WP: E/C 2,50 mm (KYLoCo098)
- Toma de impresión con tornillo incluido.
- Calcinable con tornillo clínica incluido.
- Cilindro provisional en titanio grado V según ISO-5832, con tornillo clínica incluido.
- Los PME inclinados permiten corregir disparalelismos de hasta 30 grados.

Following the first stage of surgery and therefore after implant osseointegration is achieved, the multi-esthetic abutment (MEA) is used, that is defined as the machined attachment that, after being attached to the crown of the implant, serves as a support for a multiple restoration, thus decreasing the height between the implant connection and the structure connection, and providing a passive adjustment of the structure.

### Key features


- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Available in emergency heights from 1.00 to 4.50 mm.
- One-piece straight abutments in rotary model.
- Tightened with hex keys:  
RP: B/F 2.00 mm (KYLoCo149)  
WP: B/F 2.50 mm (KYLoCo098)
- Impression coping with screw included.
- Castable with clinic screw included.
- Temporary cylinder in grade V titanium as per ISO-5832 with clinic screw included.
- Angled multi-esthetic abutments allow non-parallelism up to 30°.

## Pilares multi-estético gmi frontier - gmi frontier multi-esthetic abutments



### Pilares multi-estético inclinados Multi-esthetic angled abutments

Plataforma Platform	Ang. (º) Angle (°)	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP ●●	17º	2,50	KDGOf3609
RP ●●	17º	3,50	KDGOf3610
	30º	4,00	KDGOf3611

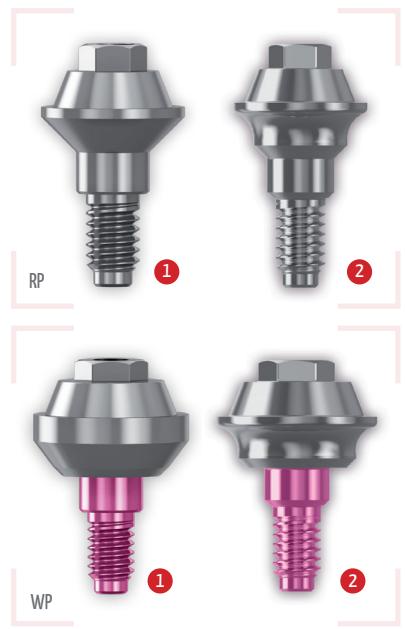

### Pilares multi-estético rectos Multi-esthetic straight abutments

Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP ●●	1,00	KDGOf3601 ①
RP ●●	1,50	KDGOf3620 ②
RP ●●	2,50	KDGOf3621 ②
RP ●●	3,50	KDGOf3622 ②
RP ●●	4,50	KDGOf3623 ②
WP ●	1,00	KDGOf3605 ①
WP ●	1,50	KDGOf3624 ②
WP ●	2,50	KDGOf3625 ②
WP ●	3,50	KDGOf3626 ②
WP ●	4,50	KDGOf3627 ②



### Pilares cicatrización PME Healing abutments MEA


Plataforma Platform	Ø Diámetro (mm) Ø Diameter (mm)	Ref.
RP ●●	Ø 4,80	KDPOF0035
RP ●●	Ø 6,00	KDPOF0037
WP ●	Ø 6,00	KDPOF0036



### Tomas impresión cubeta abierta (CA) larga PME Open tray (OT) long impression coping MEA

Plataforma Platform	Ref.
RP ●●	KDSOf0015
WP ●	KDSOf0016

## Pilares multi-estético gmi frontier - gmi frontier multi-esthetic abutments

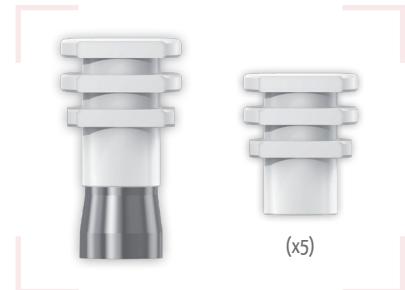

Toma impresión cubeta cerrada (CC) PME Closed tray (CT) impression coping MEA		
Plataforma Platform	Cantidad (Ud.) Quantity (Un.)	Ref.
RP ●●	1	KDSOF0017
	5	KDSOF5001



Cilindros provisionales PME Temporary cylinder MEA		
Plataforma Platform	Ref.	
RP ●●	KDGOF0028	
WP ●	KDGOF0029	



Calcinables PME Castables MEA		
Plataforma Platform	Ref.	
RP ●●	KDCOF0117	
WP ●	KDCOF0118	



Base titanio PME Titanium base MEA		
Plataforma Platform	Ref.	
RP ●●	KDGOF0035	
WP ●	KDGOF0036	



Scanbody de titanio PME Titanium scanbody MEA		
Plataforma Platform	Ref.	
RP ●●	KDIOF0002	
WP ●	KDIOF0003	

## Bases bioestéticas gmi frontier - gmi frontier bioesthetic bases

Una vez finalizada la inserción del implante en el lecho óseo se procede a utilizar la base bioestética que se define como el aditamento mecanizado que una vez fijado a la parte coronal del implante permite efectuar restauraciones unitarias a nivel del pilar.

La colocación de la base bioestética durante la cirugía permite que los tejidos blandos cicatricen alrededor de ésta.

Una vez cicatrizado el tejido, sirve como base para efectuar la rehabilitación evitando la conexión y desconexión de los componentes al implante y, por tanto, manteniendo intacto el sellado biológico.

### Características principales

- Mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Disponibles en alturas de emergencia de 1,00 a 4,00 mm.
- Bases rectas de dos piezas, incluyendo el tornillo.
- Apriete con llave hexagonal: E/C 2,00 mm (KYLoC0149).
- Toma de impresión con tornillo incluido.
- Calcinable.
- Pares apriete: Base BE (30 N·cm) y pilar cicatrización (Manual: Máx. 15 N·cm).

Once the insertion of the implant in the bone bed has been completed, the bioesthetic base is used, which is defined as the machined attachment that, once fixed to the coronal part of the implant, allows single restorations at the abutment level.

Placing the bioesthetic base during surgery allows the soft tissues to heal around it.

Once the tissue has healed, it serves as the basis for the rehabilitation, avoiding the connection and disconnection of the components to the implant and, therefore, keeping the biological seal intact.

### Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Available in emergency heights from 1.00 to 4.00 mm.
- Straight two-piece bases, including the screw.
- Tightened with hex wrench: B/F 2.00 mm (KYLoC0149).
- Impression coping with screw included.
- Castable.
- Tightening torques: BE base (30 N·cm) and healing abutment (Manual: Max. 15 N·cm).



Bases bioestéticas Bioesthetic bases		
Plataforma Platform	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP	1,00	KDGOF3612
	2,00	KDGOF3613
	3,00	KDGOF3614
	4,00	KDGOF3615
WP	1,00	KDGOF3616
	2,00	KDGOF3617
	3,00	KDGOF3618
	4,00	KDGOF3619

### Pilar cicatrización BE BE healing abutment

Plataforma Platform	Ø Diámetro (mm) Ø Diameter (mm)	Ref.
RP - WP	Ø 4,80	KDPOC0038

## Bases bioestéticas gmi frontier - gmi frontier bioesthetic bases



Toma impresión cubeta abierta (CA) BE  
BE open tray (OT) impression coping

Plataforma  
Platform

Ref.

RP - WP ● ●

KDSOF0018



Calcinable BE  
BE castable

Plataforma  
Platform

Cantidad  
Quantity

Ref.

RP - WP ● ●

10

KDCOF0019



Base de titanio BE  
BE titanium base

Plataforma  
Platform

Ref.

RP - WP ● ●

KDGOF4018



Scanbody de titanio BE  
BE titanium scanbody

Plataforma  
Platform

Ref.

RP - WP ● ●



KDIOF0004

## Réplicas gmi frontier - gmi frontier replicas

Una vez realizada la transferencia de la posición mediante la toma de impresión del medio biológico al modelo de trabajo de laboratorio, es necesario utilizar las réplicas, que se definen como el aditamento mecanizado destinado por una parte a reproducir la posición del implante en la boca del paciente a un modelo de trabajo y por otra a servir de modelo de conexión para la construcción en el laboratorio de la estructura destinada a efectuar la restauración.

### Características principales

- Mecanizadas en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Fresados anti-giro y cuello de retención vertical para una buena fijación.

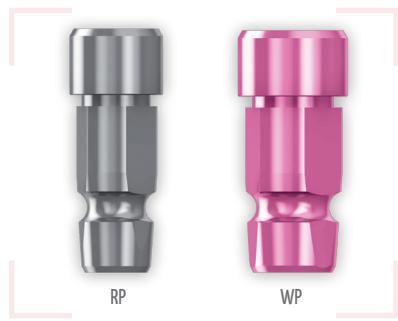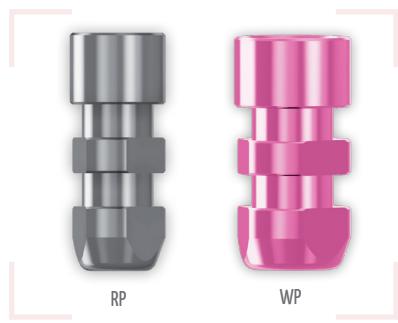

Once the transfer of the position has been made using the impression coping from the biological medium to the laboratory working model, it is necessary to use replicas, which are defined as the machined attachments designed on one hand to reproduce the implant position in the mouth of the patient to a working model, and on the other to serve as a connection model for the construction in the laboratory of the structure to carry out the restoration.

### Key features

- Grade V titanium machining as per ISO-5832 standard.
- Anti-rotation millings and vertical retention neck for a good fixation.

### Réplicas de implante Implant replicas

Plataforma Platform	Ref.
------------------------	------

RP ●● KDR0C3601

WP ● KDR0C3602

### Réplicas digitales Digital replicas

Plataforma Platform	Ref.
------------------------	------

RP ●● KDR0F3603

WP ● KDR0F3604

### Réplicas para pilares multi-estético MEA replicas

Plataforma Platform	Ref.
------------------------	------

RP ●● KDR0C0012

WP ● KDR0C0013

### Réplicas digitales para pilares multi-estético MEA digital replicas

Plataforma Platform	Ref.
------------------------	------

RP ●● KDR0F0014

WP ● KDR0F0015

## Réplicas gmi frontier - gmi frontier replicas



Réplica digital BE  
BE digital replica

Plataforma  
Platform

Ref.

RP - WP ● ●

KDR0FO016

## Tomas de impresión gmi frontier - gmi frontier impression coping

Las tomas de impresión se definen como el aditamento mecanizado que conectado a la parte coronal del implante en el interior de la cavidad bucal, y fijado axialmente mediante el tornillo de impresión, sirve para realizar la transferencia de la posición del implante en el medio biológico a un modelo de laboratorio, sobre el cual trabajará el protésico para crear las coronas o prótesis dentales. Este proceso se consigue utilizando materiales de impresión que colocados de forma apropiada, se endurecen en la cavidad bucal permitiendo la obtención del negativo de la boca del paciente. Una vez extraído, se colocan las réplicas y se efectúa el vaciado de escayola para obtener el molde positivo donde la réplica quedará en la posición original del implante en boca.

### Características principales

- Toma impresión CA mecanizada en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Tornillos de impresión mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Apriete tornillos impresión con llave hexagonal de e/c 1,20 mm.
- Macha apical para facilitar el inicio de roscado del tornillo impresión.
- Fresados anti-giro y cuello de retención vertical para una buena fijación.
- Tornillos de toma de impresión incluidos.
- Tornillo largo con fresados longitudinales para apriete manual.
- Toma de impresión CC mecanizada en plástico técnico.
- Conjunto de toma de impresión CC formado por toma impresión CC + pilar hexagonal + tornillo.

Impression coping are defined as the machined attachments that, connecting to the coronal part of the implant within the oral cavity and axially fixed by the impression screw, are used to make the transfer of the position of the implant in the biological medium to a laboratory model, on which the prosthetic will work to create the dental crowns or prostheses. This process is achieved using impression materials placed in an appropriate manner, that will harden in the oral cavity and produce the negative of the patient's mouth. Once extracted, replicas are placed and the casting plaster is poured to obtain the positive mould where the replica will be placed in the original position of the implant in the mouth.

### Key features

- Machined open tray impression coping in grade V titanium according to ISO-5832.
- Impression screws in grade V titanium according to ISO-5832.
- Tightening of impression screws with b/f 1.20 mm hex wrench.
- Apical bit to facilitate the start of threading impression screw.
- Anti-rotation millings and vertical retention neck for a good fixation.
- Impression coping screw included.
- Long impression screw with longitudinal millings for manual tightening.
- CT impression coping machined in technical plastic.
- CT impression coping whole formed by CT impression coping + hexagonal abutment + screw.



RP



WP

Tomas impresión cubeta abierta (CA)  
Open tray (OT) impression coping

Plataforma  
Platform

Tornillo  
Screw

Ref.

RP ● ●

Corto • Short

KDSOF3608

Largo • Long

KDSOF3609

WP ●


Corto • Short

KDSOF3610

Largo • Long

KDSOF3611

## Tomas de impresión gmi frontier - gmi frontier impression coping



<b>Tomas impresión cubeta cerrada (CC)</b> Closed tray (CT) impression coping	
<b>Plataforma</b> Platform	<b>Ref.</b>
RP ●●	KDSOF3612
WP ●	KDSOF3607
<b>Cantidad (Ud.)</b> Quantity (Un.)	<b>Ref.</b>
5 ●●	KDSOF0014

## Calcinables gmi frontier - gmi frontier castables

Para sustituir una corona dental con una prótesis de restauración se utiliza el calcinable, que se define como el aditamento mecanizado de plástico fundible que una vez posicionado sobre la parte coronal del implante de conexión interna servirá de base inicial para modelar la forma que tendrá la estructura final, que será colada en el metal correspondiente.


### Características principales

- Calcinables mecanizados en material plástico fundible de color blanco.
- Fisiológicamente inertes y excelente estabilidad dimensional.
- Disponibles en versión rotatoria y anti-rotatoria.
- Incluye tornillo clínica ref: KDTcC3601.

To replace a dental crown with a restoration dental prosthesis, a castable is used, which is defined as a meltable plastic machined attachment that, once positioned over the coronal part of the internal connection implant, will be the initial basis to model the form of the final structure, to be cast in the corresponding metal.

### Key features

- Machined castables in white meltable plastic material.
- Physiologically inert and excellent dimensional stability.
- Available in rotary and non-rotary version.
- Clinic screw ref.: KDTcC3601 included.



Plataforma	Tipo de conexión	Ref.
RP ●●	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDCOF3611
WP ●	Rotatoria • Rotary	KDCOF3612
	Anti-rotatoria • Non-rotary	KDCOF3613
	Rotatoria • Rotary	KDCOF3614


## Bases CrCo gmi frontier - gmi frontier CrCo bases

Las bases CrCo constan de una interfase de CrCo mecanizado y una chimenea calcinable. Esta configuración permite una mayor estabilidad dimensional en las superficies de contacto de la conexión entre el implante y el pilar.

Están indicadas para restauraciones unitarias o múltiples atornilladas ya sean mediante técnica convencional de sobrecolado o mediante soldadura láser.

The CrCo bases consist of a machined CrCo interface and a castable chimney. This configuration allows for greater dimensional stability at the contact surfaces of the implant-abutment connection.

They are indicated for single or multiple screw-retained restorations either by conventional cast-on technique or by laser welding.

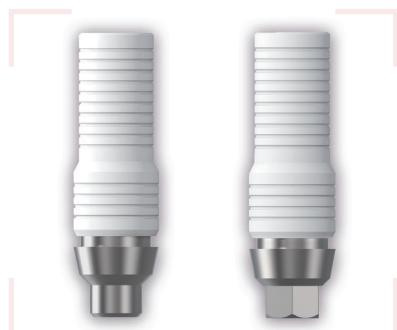

Plataforma Platform	Tipo de conexión Connection type	Ref.
RP ●●	Rotatoria • Rotary	TS30017
	Anti-rotatoria • Non-rotary	TS31017
WP ●	Rotatoria • Rotary	TS30018
	Anti-rotatoria • Non-rotary	TS31018

## Tornillos clínica y laboratorio gmi frontier - gmi frontier clinic and laboratory screws

Los tornillos clínica se definen como los aditamentos mecanizados utilizados para el anclaje definitivo de los pilares, el pilar fresable o el calcinable directo al implante, mientras que los tornillos de laboratorio son los aditamentos mecanizados utilizados para el anclaje provisional de los calcinables a la réplica del implante, utilizado por el protésico en el laboratorio donde se construyen las coronas dentales o prótesis.

Clinic screws are defined as machined devices used for the final anchoring of the abutments, the millable implant abutment or the castable directly to the implant, while laboratory screws are the machined devices used for the temporary anchoring of castables to the replica of the implant used by the dental laboratory where the construction of dental crowns or prostheses takes place.

### Características principales

- Tornillos mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Apriete tornillos con llave hexagonal de e/c 1,20 mm.
- Mecha apical para facilitar el inicio de rosado.
- Tornillo TX permite angular el canal del tornillo hasta 20°.

### Key features

- Machined grade V titanium screws according to ISO-5832.
- Tightening of screws with b/f 1.20 mm hex wrench.
- Apical bit to facilitate the start of threading.
- TX screw allows the screw channel to be angled up to 20°.



Tornillo clínica Clinic screw		
Plataforma Platform	Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Ref.
RP - WP ●●	○ 1,20 mm	KDToC3601
	⊗ TX	KDToC3609
Tornillo laboratorio Laboratory screw		
Plataforma Platform	Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Ref.
RP - WP ●●	○ 1,20 mm	KDToC3602
	⊗ TX	KDToC3610

## Tornillos PME y BE gmi frontier - gmi frontier MEA and BE screws

Los tornillos clínica para PME y BE se definen como los aditamentos mecanizados utilizados para el anclaje definitivo de los aditamentos ME y BE, mientras que los tornillos de laboratorio son los aditamentos mecanizados utilizados para el anclaje provisional de los aditamentos ME y BE a la réplica durante la elaboración de la prótesis en el laboratorio.

### Características principales

- Tornillos mecanizados en titanio grado V según norma ISO-5832.
- Apriete tornillos con llave hexagonal de e/c 1,20 mm y 2,00 mm.
- Tornillo TX permite angular el canal del tornillo hasta 20°.

MEA and BE clinical screws are defined as machined devices used for the final anchoring of the ME and BE abutments, while laboratory screws are the machined devices used for the temporary anchoring of ME and BE abutments to the replica during the fabrication of the prostheses in the laboratory.

### Key features

- Machined grade V titanium screws according to ISO-5832.
- Tightening of screws with b/f 1.20 mm and 2.00 mm hex wrench.
- TX screw allows the screw channel to be angled up to 20°.



Tornillo PME MEA screw		
Plataforma Platform	Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Ref.
RP	○ 1,20 mm	KDT0C0056
	⊗ TX	KDT0C0070
WP	○ 1,20 mm	KDT0C0060
	⊗ TX	KDT0C0071



Tornillo laboratorio PME MEA laboratory screw		
Plataforma Platform	Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Ref.
RP	○ 1,20 mm	KDT0C0057
	⊗ TX	KDT0C0072
WP	○ 1,20 mm	KDT0C0058
	⊗ TX	KDT0C0073



Tornillo BE BE screw		
Plataforma Platform	Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Ref.
RP - WP	○ 1,20 mm	KDT0C4016
	⊗ TX	KDT0C0074



## Tornillos PME y BE gmi frontier - gmi frontier MEA and BE screws



Tornillo laboratorio BE BE laboratory screw			
Plataforma Platform	Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Ref.	
RP - WP ●●	○ 1,20 mm	KDT0C4020	
	◇ TX	KDT0C0075	



Tornillo base BE BE base screw			
Plataforma Platform	Hex. llave (mm) Hex. wrench (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Ref.
RP - WP ●●	○ 2,00 mm	1,00	KDT0C3605
		2,00	KDT0C3606
		3,00	KDT0C3607
		4,00	KDT0C3608

## Pares recomendados de apriete - Recommended tightening torques

Par máximo inserción implante · Implant insertion maximum torque



Max. 60 N · cm

Apriete tapones de cierre y pilares de cicatrización · Healing abutments and cover screw tightening torque



15 N · cm (Manual)

Apriete tornillos clínica · Clinic screw tightening torque



30 N · cm

Apriete pilares bola · Ball abutments tightening torque



30 N · cm

Apriete pilares multi-estético rectos · Multi-esthetic straight abutments tightening torque



30 N · cm

Apriete tornillos multi-estético · Multi-esthetic screw tightening torque




15 N · cm

## Pares recomendados de apriete - Recommended tightening torques

Apriete tornillo pilar provisional · Temporary plastic cylinder tightening torque



Apriete tornillo pilar multi-estético inclinado · Multi-esthetic angled screw tightening torque

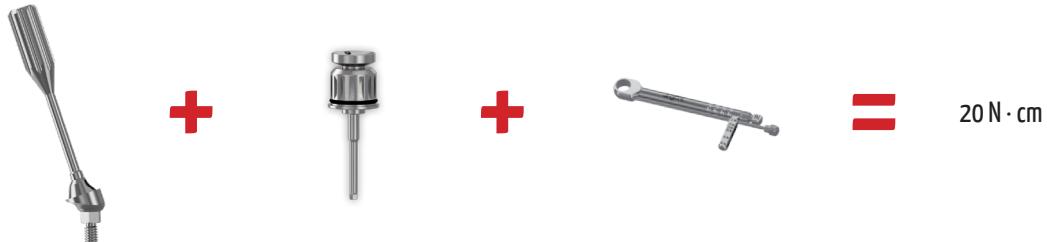

Apriete tornillo impresión · Impression coping screw tightening torque




Apriete bases bioestéticas · Bioesthetic bases tightening torque



Apriete pilar cicatrización bioestético · Bioesthetic healing abutment tightening torque



Apriete tornillo BE · BE screw tightening torque



## Kit quirúrgico gmi frontier/avantgard - gmi frontier/avantgard surgical kit

Los kits quirúrgicos gmi frontier/avantgard están formados por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene todo el material necesario para la correcta colocación de los sistemas de implantes dentales frontier y avantgard. Los componentes se encuentran dispuestos de tal manera que sea sencillo encontrar en cada momento el instrumento necesario para cada fase de la intervención.

Los kits quirúrgicos gmi se distribuyen en cajas confeccionadas en polímero técnico de alta resistencia y deben esterilizarse en autoclave de calor húmedo antes de su uso a una temperatura máxima de 134°C.

Para complementar este kit gmi dispone del **Kit de fresas PEAK** permitiendo ampliar de forma fácil y práctica su uso para la colocación de 2 sistemas de implantes adicionales (frontier PEAK y avantgard PEAK).

gmi frontier/avantgard surgical kits consist of an autoclavable case made of high strength resin, containing all the necessary material for the correct positioning of gmi frontier and avantgard dental implant systems. The components are arranged in such a way to be easy to find in each moment and in any stage of the intervention.

gmi surgical kits are distributed in boxes made of high strength technical polymer, and must be sterilized in a moist heat autoclave before use at a maximum temperature of 134°C.

To complement this kit, gmi has the PEAK drill Kit, allowing it to be easily expanded for the placement of 2 additional implant systems (frontier PEAK and avantgard PEAK).

### Kit quirúrgico gmi frontier/avantgard - gmi frontier/avantgard surgical kit

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa lanza	1	KYFOC1225
Fresa bola ø2,0 mm	1	KYFOC1502
Fresa piloto ø2,50 mm	1	KYFOC2250
Fresa escalonada ø2,50 / ø3,00 mm	1	KYFOC5130
Fresa escalonada ø3,00 / ø3,50 mm	1	KYFOC5135
Fresa escalonada ø3,50 / ø4,00 mm	1	KYFOC5140
Fresa escalonada ø4,00 / ø4,50 mm	1	KYFOC5145
Fresa cortical ø3,65 mm	1	KYFOC4336
Fresa cortical ø4,00 mm	1	KYFOC4340
Fresa cortical ø4,50 mm	1	KYFOC4345
Fresa cortical ø4,90 mm	1	KYFOC4349
Fresa cortical ø5,90 mm	1	KYFOC4359
Llave transportador plana 45°	1	KYLOCO093
Llave carraca IP	1	KYLOF0113
Llave-transportador HEX-2,45 mm IP corta	1	KYLOF0096
Llave-transportador HEX-2,45 mm IP larga	1	KYLOF0111
Llave-transportador HEX-2,45 mm CA	1	KYLOF0091
Llave-transportador Avantgard HEX-3,00 mm IP corta	1	KYLOF0137
Llave-transportador Avantgard HEX-3,00 mm IP larga	1	KYLOF0138
Llave-transportador Avantgard HEX-3,00 mm CA	1	KYLOF0136
Llave carraca corta HEX-1,20 mm	1	KYLOF0128
Llave carraca larga HEX-1,20 mm	1	KYLOF0129
Alargador fresas	1	KYLOCO023
Paralelizador ø2,00 / ø2,80 mm	3	KYLOCO078
Indicador profundidad ø2,50 mm	1	KYLOCO165

### Kit fresas gmi PEAK - gmi PEAK drill kit

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa escalonada ø2,00 / ø2,80 mm	1	KYFOC5128
Fresa escalonada ø3,20 / ø3,65 mm	1	KYFOC5137
Fresa escalonada ø3,70 / ø4,15 mm	1	KYFOC5142
Fresa escalonada ø4,15 / ø4,65 mm	1	KYFOC5147
Fresa cónica ø3,20 mm	1	KYFOC7032
Fresa cónica ø3,70 mm	1	KYFOC7037
Fresa cónica ø4,20 mm	1	KYFOC7042
Fresa cortical ø3,65 mm	1	KYFOC4337
Fresa cortical ø4,15 mm	1	KYFOC4342
Fresa cortical ø4,65 mm	1	KYFOC4347

 **Llaves de inserción avantgard PEAK vendidas por separado - Avantgard PEAK insertion wrenches sold separately**

## Kit quirúrgico gmi PEAK - gmi PEAK surgical kit

Los kits quirúrgicos gmi PEAK están formados por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene todo el material necesario para la correcta colocación de los sistemas de implantes dentales frontier PEAK y avantgard PEAK. Los componentes se encuentran dispuestos de tal manera que sea sencillo encontrar en cada momento el instrumento necesario para cada fase de la intervención.

Los kits quirúrgicos gmi se distribuyen en cajas confeccionadas en polímero técnico de alta resistencia y deben esterilizarse en autoclave de calor húmedo antes de su uso a una temperatura máxima de 134°C.

Para complementar este kit gmi dispone del **Kit de fresas frontier/avantgard** permitiendo ampliar de forma fácil y práctica su uso para la colocación de 2 sistemas de implantes adicionales (frontier y avantgard).

gmi PEAK surgical kit consist of an autoclavable case made of high strength resin, containing all the necessary material for the correct positioning of gmi frontier PEAK and avantgard PEAK dental implant systems. The components are arranged in such a way to be easy to find in each moment and in any stage of the intervention.

gmi surgical kits are distributed in boxes made of high strength technical polymer, and must be sterilized in a moist heat autoclave before use at a maximum temperature of 134°C.

To complement this kit, gmi has the **frontier/avantgard drill Kit**, allowing it to be easily expanded for the placement of 2 additional implant systems (frontier and avantgard).

### Kit quirúrgico gmi PEAK - gmi PEAK surgical kit

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa bola ø2,0 mm	1	KYFOC1502
Fresa inicial ø2,0 mm	1	KYFOC1401
Fresa cónica ø3,20 mm	1	KYFOC7032
Fresa cónica ø3,70 mm	1	KYFOC7037
Fresa cónica ø4,20 mm	1	KYFOC7042
Fresa cortical ø3,65 mm	1	KYFOC4337
Fresa cortical ø4,15 mm	1	KYFOC4342
Fresa cortical ø4,65 mm	1	KYFOC4347
Fresa escalonada ø2,00 / ø2,80 mm	1	KYFOC5128
Fresa escalonada ø3,20 / ø3,65 mm	1	KYFOC5137
Fresa escalonada ø3,70 / ø4,15 mm	1	KYFOC5142
Fresa escalonada ø4,15 / ø4,65 mm	1	KYFOC5147
Indicador profundidad ø2,00 mm	1	KYLOCO164
Indicador profundidad cónico ø3,20 mm	1	KYLOCO159
Indicador profundidad cónico ø3,70 mm	1	KYLOCO160
Indicador profundidad cónico ø4,20 mm	1	KYLOCO161
Llave carraca IP	1	KYLOFO113
Llave Avantgard CA corta	1	KYLOCO151
Llave Avantgard carraca corta	1	KYLOCO157
Llave Avantgard carraca larga	1	KYLOCO162
Llave carraca corta HEX - 1,20 mm	1	KYLOFO128
Llave carraca larga HEX - 1,20 mm	1	KYLOFO129
Alargador fresas	1	KYLOCO023
Paralelizador ø2,00 / ø2,80 mm	3	KYLOCO078
Llave-transportador HEX - 2,45 mm IP corta	1	KYLOFO096
Llave-transportador HEX - 2,45 mm IP larga	1	KYLOFO111
Llave-transportador HEX - 2,45 mm CA	1	KYLOFO091

### Kit fresas gmi frontier/avantgard - gmi frontier/avantgard drill kit

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa piloto ø2,50 mm	1	KYFOC2250
Fresa escalonada ø2,50 / ø3,00 mm	1	KYFOC5130
Fresa escalonada ø3,00 / ø3,50 mm	1	KYFOC5135
Fresa escalonada ø3,50 / ø4,00 mm	1	KYFOC5140
Fresa escalonada ø4,00 / ø4,50 mm	1	KYFOC5145
Fresa cortical ø3,65 mm	1	KYFOC4336
Fresa cortical ø4,00 mm	1	KYFOC4340
Fresa cortical ø4,50 mm	1	KYFOC4345
Fresa cortical ø4,90 mm	1	KYFOC4349
Fresa cortical ø5,90 mm	1	KYFOC4359

 **Llaves de inserción avantgard vendidas por separado - Avantgard insertion wrenches sold separately**









KYCOF3017



KYCOF3045

## Especificaciones técnicas - Technical specifications

Hex. llave  
 Conexión AR  
 Conexión R

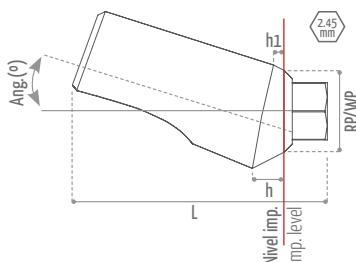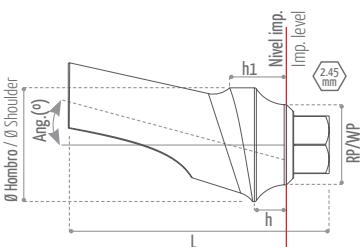

### Pilares de cicatrización - Healing abutments (mm)

Referencia - Reference	L	h	h gingival	Ø Cabeza - Ø Head	Plataforma - Platform
KDPOC3601	7,60	2,00	1,00		
KDPOC3602	8,60	3,00	2,00		
KDPOC3603	9,60	4,00	3,00		
KDPOC3604	10,60	5,00	4,00		
KDPOC3605	7,60	2,00	1,00	Ø 4,00	RP
KDPOC3606	8,60	3,00	2,00		
KDPOC3607	9,60	4,00	3,00	Ø 5,00	WP
KDPOC3608	10,60	5,00	4,00		
KDPOC3609	8,60	3,00	1,50		
KDPOC3617	7,90	3,00	1,50		
KDPOC3618	8,90	4,00	2,50	Ø 5,00	RP
KDPOC3619	9,90	5,00	3,50		
KDPOC3620	10,90	6,00	4,50		
KDPOC3613	8,60	3,00	1,50		
KDPOC3621	7,90	3,00	1,50		
KDPOC3622	8,90	4,00	2,50	Ø 6,00	WP
KDPOC3623	9,90	5,00	3,50		
KDPOC3624	10,90	6,00	4,50		

### Pilares fresables - Millable-implant abutments (mm)

Referencia - Reference	L	h	h1	Ø Hombro - Ø Shoulder	Plataforma - Platform
KDBOF3603	8,80	1,40	7,00	Ø 4,50	RP
KDBOF3602	8,70	1,40	7,00	Ø 4,50	WP

### Pilares inclinados estéticos - Esthetic angled abutments (mm)

Referencia - Reference	L	h	h1	Ang. (°)	Ø Hombro - Ø Shoulder	Plataforma - Platform
KDMOF3634	11,00	1,30	2,60	15°		
KDMOF3635	11,00	1,30	2,60	20°		
KDMOF3636	11,00	1,25	2,55	15°	Ø 4,80	RP
KDMOF3637	11,00	1,25	2,55	20°	Ø 5,50	WP


### Pilares inclinados - Angled abutments (mm)

Referencia - Reference	L	h	h1	Ang. (°)	Plataforma - Platform
KDMOF3613	10,80	1,50	0,50	20°	RP
KDMOF3614	10,80	1,00	0,50	20°	WP


### Pilares rectos - Straight abutments (mm)

Referencia - Reference	L	h	h1	Ø Hombro - Ø Shoulder	Plataforma - Platform
KDMOF3628	10,20	1,50	6,90		
KDMOF3629	11,20	2,50	6,90	Ø 4,50	RP
KDMOF3630	12,20	3,50	6,90		
KDMOF3631	10,20	1,50	6,90		
KDMOF3632	11,20	2,50	6,90	Ø 5,50	WP
KDMOF3633	12,20	3,50	6,90		


## Especificaciones técnicas - Technical specifications




Base de titanio - Titanium base (mm)						
Referencia - Reference	L	h	h1	Ø Hombro - Ø Shoulder	Conexión - Connection	Plataforma - Platform
KDMoF3615	7,10	0,65	4,70	Ø 4,30	Anti-rotatoria - Non-rotary	RP
KDMoF3616	6,60	0,65	4,70	Ø 4,30	Rotatoria - Rotary	
KDMoF3638	8,00	1,50	4,70	Ø 4,30	Anti-rotatoria - Non-rotary	
KDMoF3640	7,50	1,50	4,70	Ø 4,30	Rotatoria - Rotary	
KDMoF3639	9,50	3,00	4,70	Ø 4,30	Anti-rotatoria - Non-rotary	
KDMoF3641	9,00	3,00	4,70	Ø 4,30	Rotatoria - Rotary	
KDMoF3617	7,10	0,65	4,70	Ø 5,30	Anti-rotatoria - Non-rotary	
KDMoF3618	6,50	0,65	4,70	Ø 5,30	Rotatoria - Rotary	
KDMoF3642	8,00	1,50	4,70	Ø 5,30	Anti-rotatoria - Non-rotary	
KDMoF3644	7,35	1,50	4,70	Ø 5,30	Rotatoria - Rotary	
KDMoF3643	9,50	3,00	4,70	Ø 5,30	Anti-rotatoria - Non-rotary	WP
KDMoF3645	8,85	3,00	4,70	Ø 5,30	Rotatoria - Rotary	




Pilar escaneado - Scan abutment (mm)				
Referencia - Reference	L	h	Ø Hombro - Ø Shoulder	Plataforma - Platform
KDloF3601	11,70	5,30	Ø 4,30	RP
KDloF3602	11,70	5,30	Ø 5,30	WP

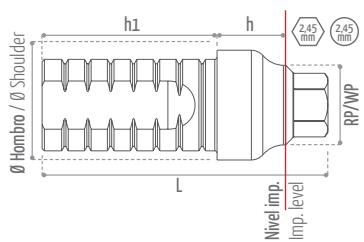

Pilares provisionales - Temporary cylinders (mm)						
Referencia - Reference	L	h	h1	Ø Hombro - Ø Shoulder	Conexión - Connection	Plataforma - Platform
KDHoF3605	12,50	3,00	7,65	Ø 4,80	Anti-rotatoria - Non-rotary	RP
KDHoF3607	12,50	3,00	7,50	Ø 4,80	Rotatoria - Rotary	
KDHoF3606	12,50	3,00	7,60	Ø 5,80	Anti-rotatoria - Non-rotary	
KDHoF3608	12,50	3,00	7,60	Ø 5,80	Rotatoria - Rotary	WP




Pilares bola - Ball abutments (mm)				
Referencia - Reference	L	h	Ø Hombro - Ø Shoulder	Plataforma - Platform
KDFoF3609	9,90	1,00	Ø 3,45	RP
KDFoF3610	10,90	2,00		
KDFoF3611	11,90	3,00		
KDFoF3612	12,90	4,00		




Pilares multi-estético rectos - Multi-esthetic straight abutments (mm)				
Referencia - Reference	L	h	Ø Plat. protésica - Ø Prosthetic plat.	Plataforma - Platform
KDG0C3601	8,10	1,00	Ø 4,80	RP
KDG0C3620	8,70	1,50		
KDG0C3621	9,70	2,50		
KDG0C3622	10,70	3,50		
KDG0C3623	11,70	4,50		
KDG0C3605	8,00	1,00		
KDG0C3624	8,60	1,50		
KDG0C3625	9,60	2,50	Ø 6,00	WP
KDG0C3626	10,60	3,50		
KDG0C3627	11,60	4,50		


## Especificaciones técnicas - Technical specifications




Pilares multi-estético inclinados - Multi-esthetic angled abutments (mm)				
Referencia - Reference	Ang. (°)	L	h	Plataforma - Platform
KDGOF3609	17°	6,20	2,50	1,30
KDGOF3610	17°	7,20	3,50	2,40
KDGOF3611	30°	7,20	4,00	1,80

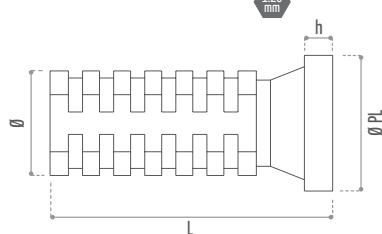


Cilindros provisionales PME - Temporary cylinder MEA (mm)			
Referencia - Reference	L	h	Ø
KDGOF0028	10,00	1,00	3,70
KDGOF0029	10,00	1,00	4,90




Base titanio PME - Titanium base MEA (mm)			
Referencia - Reference	L	h	Ø
KDGOF0035	4,50	0,50	2,85
KDGOF0036	4,50	0,50	3,95



Pilares cicatrización PME - Healing abutments MEA (mm)			
Referencia - Reference	L	Ø Máx / Ø Max	Ø PL
KDPOF0035	3,80	4,80	4,80
KDPOF0037	3,80	6,00	4,80
KDPOF0036	3,80	6,00	6,00




Bases bioestéticas - Bioesthetic bases (mm)			
Referencia - Reference	L	h	Plataforma - Platform
KDGOF3612	3,65	1,4	
KDGOF3613	4,65	2,4	
KDGOF3614	5,65	3,4	
KDGOF3615	6,65	4,4	
KDGOF3616	3,65	1,4	
KDGOF3617	4,65	2,4	
KDGOF3618	5,65	3,4	
KDGOF3619	6,65	4,4	




Base titanio BE - BE titanium base (mm)				
Referencia - Reference	L	h	h1	Ø
KDGOF4018	6,00	4,95	0,35	3,00


## Especificaciones técnicas - Technical specifications




Pilar cicatrización BE - BE healing abutment (mm)		
Referencia - Reference	h	Ø PL
KDPO0038	2,20	4,80




Tomas impresión cubeta abierta (CA) - Open tray (OT) impression coping (mm)						
Referencia - Reference	L	h	h1	Ø Hombr - Ø Shoulder	Tornillo - Screw	Plataforma - Platform
KDSOF3608	12,00	10,20	---	Ø 4,50	Corto - Short	RP
KDSOF3609	12,00	10,20	5,00	Ø 4,50	Largo - Long	
KDSOF3610	12,00	10,20	---	Ø 5,50	Corto - Short	
KDSOF3611	12,00	10,20	5,00	Ø 5,50	Largo - Long	WP




Tornillo clínica - Clinic screw (mm)				
Referencia - Reference	L	h	Ø	Plataforma - Platform
○ KDToc3601	7,80	2,20	2,30	RP - WP
○ KDToc3609	6,60	1,50	2,20	



Tornillo PME - MEA screw (mm)				
Referencia - Reference	L	h	Ø	Plataforma - Platform
○ KDToc0056	3,40	1,40	2,00	RP
○ KDToc0070	3,40	1,40	2,10	
○ KDToc0060	3,40	1,40	2,80	WP
○ KDToc0071	3,40	1,40	2,80	



Tornillo BE - BE screw (mm)				
Referencia - Reference	L	h	Ø	Plataforma - Platform
○ KDToc4016	3,90	1,50	2,00	RP - WP
○ KDToc0074	3,90	1,50	2,10	



Tornillo base BE - BE base screw (mm)				
Referencia - Reference	L	h	Ø	Plataforma - Platform
KDToc3605	7,20	2,00		
KDToc3606	8,00	2,80	2,30	RP - WP
KDToc3607	9,00	3,80		
KDToc3608	10,00	4,80		





 GMI  
Dental Implantology, S.L.

Pol. Ind. El Segre  
C/ Enginyer Mies 705-B  
25191 Lleida (SPAIN)  
Tel. (+34) 973 184 350  
[info@gmidental.com](mailto:info@gmidental.com)  
[www.gmidental.com](http://www.gmidental.com)



Distribuido por:  
Distributed by:

